

⚠ Advertencias:

- ❖ Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el termómetro digital.
- ❖ **Riesgo de asfixia: La tapa y la batería del termómetro pueden resultar letales si se ingieren. No permita que los niños utilicen el dispositivo sin supervisión parental.**
- ❖ No utilice el termómetro en el oído. Diseñado solo para lecturas orales, rectales y de axila.
- ❖ No coloque la batería del termómetro cerca de calor extremo ya que podría explotar.
- ❖ Retire la batería del dispositivo cuando no le dé uso por un periodo prolongado.
- ❖ El uso de las lecturas de temperatura para autodiagnóstico es peligroso. Consulte a su médico para la interpretación de los resultados. El autodiagnóstico puede llevar a un empeoramiento de las condiciones de la enfermedad existente.
- ❖ No realice mediciones cuando el termómetro esté húmedo ya que puede dar lugar a medición inexactas.
- ❖ No muerda el termómetro. Hacerlo puede resultar en rotura del dispositivo y/o lesiones.
- ❖ No intente desmontar o reparar el termómetro. Hacerlo puede resultar en lecturas incorrectas.
- ❖ Desinfecte el termómetro después de cada uso, en especial en caso de que el aparato sea utilizado por más de una persona.
- ❖ No fuerce el termómetro dentro del recto. Pare la inserción y cancele la lectura si presenta dolor. El no hacerlo puede provocar lesiones.
- ❖ No utilice el termómetro oralmente después de haberlo utilizado rectalmente.
- ❖ **Para niños de 2 años o menos, por favor, no utilice el dispositivo por vía oral.**
- ❖ Si la unidad se ha guardado a temperaturas fuera del rango de 5°C - 40°C (41°F - 104°F), déjelo a una temperatura ambiente de 5°C - 40°C (41°F - 104°F) durante más o menos 15 minutos antes de utilizarla.
- ❖ Debe evitarse el uso de este equipo junto a otros equipos o apilado con ellos, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto. Si es necesario utilizarlo, se debe observar este equipo y el otro para verificar que funcionan con normalidad.
- ❖ Los equipos portátiles de comunicaciones de RF (incluidos los periféricos, como cables de antena y antenas externas) no deben utilizarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del [EQUIPO EM o SISTEMA EM], incluidos los cables especificados por el FABRICANTE. De lo contrario, podrían degradarse las prestaciones de este equipo.
- ❖ No está previsto su uso en entornos ricos en oxígeno y en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nítrico.
- ❖ No exponga el termómetro a la luz solar directa, de lo contrario la precisión se verá afectada.
- ❖ El equipo EM no debe limpiarse ni desinfectarse mientras se utiliza.

❖ Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente (AEMPS).

Indicaciones de uso

Los termómetros digitales están pensados para medir la temperatura corporal humana de forma oral, rectal o axilar. Los aparatos son reutilizables para uso clínico o doméstico en personas de todas las edades, incluyendo niños menores de 8 años bajo la supervisión de un adulto.

Usuario previsto

- ❖ El paciente es un usuario previsto. La parte aplicada es la sonda.
- ❖ Todas las funciones pueden ser usadas por el paciente de forma segura.
- ❖ El paciente puede reemplazar las pilas.

Por favor, lea detenidamente antes de usar

Este termómetro digital proporciona una lectura rápida y de gran precisión de la temperatura corporal del individuo. Para entender mejor sus funciones y proporcionar años de resultados fiables, por favor, lea primero todas las instrucciones.

Este dispositivo se ajusta a las siguientes normativas:

ISO 80601-2-56 Equipos electromédicos - Parte 2-56: Requisitos específicos para la seguridad básica y el funcionamiento esencial de termómetros clínicos para la medición de la temperatura corporal.


EN 60601-1-11 Equipos electromédicos - Parte 1-11: Requisitos generales para la seguridad básica y el funcionamiento esencial - Norma colateral: Requisitos para el equipo electromédico y el sistema electromédico utilizado para el cuidado en el entorno médico del hogar y cumple con los requerimientos de las normas EN 60601-1-2 (CEM), IEC/EN60601-1 (Seguridad). Y el fabricante tiene certificado ISO 13485.

Contenidos

1 Termómetro, 1 Manual del usuario, 1 Estuche.

Ilustración del producto

Figura 1

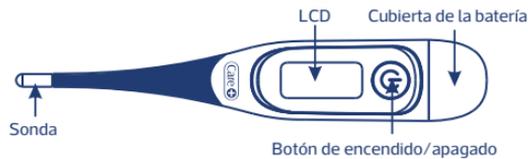

Precaución



- * El rendimiento del aparato puede deteriorarse si ocurren una o más de las siguientes situaciones:
 - Opera fuera del rango de temperatura y humedad especificado por el fabricante.
 - Se almacena fuera del rango de temperatura y humedad especificado por el fabricante.
 - Sacudida mecánica (por ejemplo, prueba de caída) o deterioro del sensor.
 - La temperatura del paciente está por debajo de la temperatura ambiente.
- * Las comunicaciones RF portátiles y móviles pueden afectar al aparato. Este aparato necesita precauciones especiales relativas a la CEM de acuerdo con la información de CEM proporcionada en los documentos acompañantes.
- * No utilice el dispositivo en el entorno RM (Resonancia Magnética).

Explicación de los símbolos

- Corriente continua
- Parte aplicada tipo BF
- Consulte los documentos acompañantes
- Representante Europeo Autorizado
- Fecha de Fabricación
- Número de referencia
- La eliminación de este producto y de las pilas usadas debe realizarse de acuerdo con la normativa nacional para la eliminación de productos electrónicos
- Advertencia
- LOT Número de lote
- Fabricante
- Límite de temperatura de almacenamiento y transporte: -20°C - 55°C (-4°F - 131°F)
- Límite de humedad relativa de almacenamiento y transporte 15% - 95% HR
- El marcado CE de conformidad 0197 representa el número de identificación del organismo notificado
- IP27 El primer número, 2: Protección contra partículas sólidas de 12,5 mm de diámetro o más. El segundo número, 7: Protección ante los efectos de inmersiones temporales en agua

Especificaciones

Tipo:	Termómetro digital (No predictivo)
Rango de medición:	32,0°C - 43,9°C (90,0°F - 111,9°F) (°C/°F elegido por el fabricante)
Precisión:	±0,1°C (±0,2°F) para un rango de medición de 35,5°C - 42,0°C (95,9°F - 107,6°F) a una temperatura ambiente de 18°C - 28°C (64,4°F - 82,4°F). ±0,2°C (±0,4°F) cuando la temperatura ambiente y de medición están fuera de los rangos anteriores
Modo de funcionamiento:	Modo directo
Pantalla:	Pantalla de cristal líquido, 3 1/2 dígitos
Memoria:	Almacenamiento del último valor medido
Batería:	Una pila de botón 1,5 V CC. (tamaño LR41 o SR41, UCC 392)
Duración de la batería:	Aproximadamente 200 horas de funcionamiento continuo o 1 año con 3 mediciones al día
Dimensiones:	14,3 cm x 2,5 cm x 1,4 cm (Largo x Ancho x Alto)
Peso:	16 gramos aprox. incluyendo la batería
Vida útil esperada:	Tres años
Rango de funcionamiento ambiente:	Temperatura: 5°C - 40°C (41°F - 104°F) Humedad relativa: 15% - 95% HR Presión atmosférica: 70 kPa - 106 kPa
Condiciones de almacenamiento y transporte:	Temperatura: -20°C - 55°C (-4°F - 131°F) Humedad relativa: 15% - 95% HR Presión atmosférica: 70 kPa - 106 kPa
Contraindicación	Sin contraindicaciones
Clasificación de protección de ingreso:	IP 27
Clasificación:	Tipo BF

Selector °C/°F

Las lecturas de temperatura están disponibles en escala Celsius o Fahrenheit (°C/°F, localizados en la esquina superior derecha de la LCD). Con la unidad apagada, presione y mantenga el botón de Encendido/Apagado durante aproximadamente 2 segundos para cambiar los ajustes actuales.

Instrucciones

1. Presione el botón de Encendido/Apagado al lado de la pantalla LCD. Sonará una señal mientras la pantalla muestra "88.8°C", seguida de la última temperatura registrada. Después de mostrar la temperatura de autocomprobación, el termómetro está ahora en modo de prueba.

2. Coloque el termómetro en el lugar deseado (boca, recto o axila).

a) Uso oral: Coloque el termómetro bajo la lengua como se indica en la posición "✓" mostrada en la Figura 2. Cierre la boca y respire regularmente por la nariz para evitar que la medición sea influenciada por el aire inhalado/exhalado.




Figura 2

b) Uso rectal: Lubrique la punta de sonda plateada con vaselina para una fácil inserción. Inserte delicadamente el sensor aproximadamente 1cm en el recto.

c) Uso en la axila: Seque la axila. Coloque la sonda en la axila y mantenga el brazo presionado firmemente contra el costado. **Desde el punto de vista médico, este método siempre proporciona lecturas inexactas, y no debe utilizarse si se necesitan lecturas precisas.**

3. El signo de grado parpadeará durante el proceso de prueba. Cuando el parpadeo cese, sonará una alarma que pitará durante aproximadamente 10 segundos. La lectura tomada aparecerá en la LCD simultáneamente. El tiempo de medición mínimo hasta el tono de señal (pitido) debe mantenerse sin excepción. La medición continúa incluso después de la notificación acústica.

Así que, para conseguir un mejor resultado de medición de la temperatura corporal, recomendamos mantener la sonda en la boca y el recto durante 2 minutos, o durante 5 minutos en la axila independientemente del pitido y debe ser mantenido durante un intervalo de medición de al menos 30 segundos.

***Nota:** Normalmente los sonidos son "Bi-Bi-Bi-Bi"; La alarma pita más rápido cuando la temperatura alcanza los 37,8 °C (100°F) o más, y los sonidos son "Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi".

4. Para alargar la vida de la batería, presione el botón de Encendido/Apagado para apagar la unidad después de que se complete la prueba. Si no hay ninguna acción, la unidad se apagará automáticamente después de unos 10 minutos.

Resolución de problema

Mensaje de error	Problema	Solución
Lo	La temperatura tomada es más baja de 32,0°C (90,0°F)	Apague, espere un minuto y tome de nuevo la temperatura por contacto estrecho y con descanso suficiente
Hi	La temperatura tomada es más alta de 43,9°C (111,9°F)	Apague, espere un minuto y tome de nuevo la temperatura por contacto estrecho y con descanso suficiente
Err	El sistema no funciona adecuadamente	Retire la batería, espere 1 minuto y recolóquela. Si el mensaje reaparece, contacte con el vendedor para asistencia
	Batería agotada: El icono de la batería parpadea, no se puede medir	Cambie la batería

Cambio de la batería

- Cambie la batería cuando " " aparezca en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.
- Retire la cubierta de la batería como se muestra en la Figura 3.
- Tire suavemente de la placa de circuito de plástico con la cámara de la batería aproximadamente 1 cm. (Ver Figura 4)
- Utilice un objeto con punta como un bolígrafo para quitar la pila antigua. Deseche la pila conforme a la normativa aplicable. Cámbiela por una nueva 1,5V CC de tipo botón LR41 o SR41, UCC392, o equivalente. Asegúrese que la batería está instalada con la polaridad "+" hacia arriba. (Vea la Figura 5).
- Deslice la cámara de la batería a su lugar y coloque la cubierta.




Figura 3



Figura 4




Figura 5

Calibrado

El termómetro es calibrado inicialmente en el momento de su fabricación. Si el termómetro se utiliza de acuerdo a las instrucciones de uso, no es necesario un reajuste periódico. Sin embargo, recomendamos comprobar el calibrado cada dos años o siempre que la exactitud clínica del termómetro esté en duda. Encienda el termómetro e insértelo en el baño de agua y compruebe la exactitud de laboratorio del termómetro. Por favor, envíe el dispositivo completo al vendedor o el fabricante.

Las recomendaciones anteriores no sustituyen los requerimientos legales. El usuario debe cumplir con los requerimientos legales para el control de mediciones, funcionamiento y exactitud del dispositivo que sean necesarias por el alcance de las leyes pertinentes, directivas y ordenanzas donde el dispositivo se utilice.

Limpieza y desinfección

- Sumerja la sonda del termómetro en agua destilada durante al menos 1 minuto.
 - Utilice un paño suave y limpio para limpiar el termómetro y eliminar cualquier residuo.
 - Repita los pasos 1 y 2 tres veces hasta que no haya suciedad en la inspección visual después de la limpieza.
 - Para una limpieza y desinfección en profundidad, por favor, utilice el método A o B:
 - Método A (Nivel alto de desinfección): sumerja la sonda del termómetro en OPA (O-Phtaldehyde) al 0,55%, como el CIDEX OPA, durante al menos 12 minutos bajo una temperatura de 20°C (68°F).
 - Método B (Bajo nivel de desinfección): Utilizando un paño suave y limpio empape en alcohol médico al 0%, limpie la sonda 3 veces al menos un minuto cada vez.
 - Repita los pasos 1 al 3 para eliminar los residuos de OPA;
 - Nota 1: El uso rectal no está recomendado para uso doméstico ya que el OPA no es de fácil acceso fuera del hospital. Si la medición rectal es necesaria, recomendamos insistentemente un alto nivel de desinfección.
 - Nota 2: Por favor, proceda de acuerdo al manual de instrucciones de OPA para referencia.
- Para evitar daño al termómetro, por favor, tenga en cuenta y observe lo siguiente:
- No utilice benceno, disolvente, gasolina u otros disolventes fuertes para limpiar el termómetro.
 - No intente desinfectar la sonda de detección (punta) del termómetro sumergiéndola en alcohol, OPA o en agua caliente (agua por encima de 50°C (122°F)) durante mucho tiempo.
 - No utilice limpieza ultrasónica para limpiar el termómetro.

Garantía limitada

El termómetro tiene garantía de 3 años desde la fecha de compra. Si el termómetro no funciona adecuadamente debido a componentes defectuosos o defectos de fabricación, lo repararemos o cambiaremos sin coste alguno. Todos los componentes están cubiertos por esta garantía excluyendo la batería. La garantía no cubre daños de su termómetro debido a un manejo incorrecto. Para obtener asistencia por la garantía, será necesario el original o copia del ticket de compra del vendedor original.

Servicio de Atención al consumidor de NOVAELECTRONICA IBERIA, S.L. para cualquier duda o incidencia con este dispositivo:

91 617 42 59 | L M X J 9:00 - 14:00 · 15:00 - 18:30
V 8:30 - 14:30

info@novaelectronica.com

El identificador del software se refiere al documento del Informe de validación del software, el código del archivo es JIRJ201201001 y la versión del archivo es A0.

Información de compatibilidad electromagnética (CEM)

Este dispositivo satisface los requerimientos CEM de la norma internacional IEC 60601-1-2. Estos requerimientos se cumplen bajo las condiciones descritas en la TABLA inferior. Este dispositivo es un producto médico eléctrico y está sujeto a medidas de precaución especiales de acuerdo a CEM que deben estar publicadas en las instrucciones de uso. Las comunicaciones de alta frecuencia portátiles y móviles pueden afectar al aparato. El uso de la unidad en conjunto con accesorios no aprobados puede afectar negativamente al dispositivo y alterar la compatibilidad electromagnética. Este aparato no debe utilizarse al lado o entre otro equipamiento eléctrico.

TABLA 1

Guía y declaración del fabricante - emisión electromagnética		
Este dispositivo está pensado para su uso en el entorno electromagnético especificado abajo. El cliente o usuario del dispositivo debe asegurarse que se usa en dicho entorno		
Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
Emisiones RF CISPR 11	Grupo 1	Este dispositivo utiliza energía RF solo para su funcionamiento interno. Por este motivo, sus emisiones RF son muy bajas y no es probable que causen ninguna interferencia en los equipos electrónicos cercanos
Emisiones RF CISPR 11	Clase B	Este dispositivo es adecuado para utilizarse en todos los establecimientos, incluyendo establecimientos domésticos y aquellos directamente conectados a un suministro de energía pública de bajo voltaje que provee a edificios utilizados para propósitos domésticos
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	No aplica	
Emisiones de fluctuaciones y parpadeo de tensión IEC 61000-3-3	No aplica	

TABLA 2

Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética			
Este dispositivo está pensado para su uso en el entorno electromagnético especificado abajo. El cliente o usuario del dispositivo debe asegurarse de que se usa en dicho entorno			
Prueba de inmunidad	IEC 60601 resultados de las pruebas	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contacto ±2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aire	± 8 kV contacto ±2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aire	Los suelos deben ser de madera, cemento o baldosa cerámica. Si los suelos están cubiertos de material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos el 30%
Transitorios/ráfagas electrostáticas IEC 61000-4-4	±2 kV para fuentes de alimentación 100 kHz frecuencia de repetición ±1kV para líneas de entrada/salida	N/A	N/A
Sobrecarga IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV modo diferencial línea-línea	N/A	N/A
Caidas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada del suministro de energía IEC 61000-4-11	0% UT (100% inmersión en UT) para 0,5 ciclo a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, y 315° 0% UT (100% inmersión en UT) para 1 ciclo a 0° 70% UT (30% inmersión en UT) para 25/30 ciclos a 0° 0% UT (100% inmersión en UT) para 250/300 ciclos a 0°	N/A	N/A
Frecuencia eléctrica (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	30 A/m, 50/60Hz	30 A/m, 50/60Hz	Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben estar a niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospital típicos

NOTA: UT es la tensión de red alterna anterior a la aplicación de la prueba de nivel

TABLA 3

Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética			
Este dispositivo está pensado para su uso en el entorno electromagnético especificado abajo. El cliente o usuario del dispositivo debe asegurarse de que se usa en dicho entorno.			
Prueba de inmunidad	IEC 60601 resultados de las pruebas	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
RF conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 6 Vrms 150 kHz a 80 MHz fuera de bandas ISM	N/A	<p>Los equipos de comunicación RF portátiles y móviles no deben utilizarse más cerca de cualquier parte del dispositivo, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada, calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor</p> <p>Distancia de separación recomendada</p> $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80\text{MHz a } 800\text{MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80\text{MHz a } 2,7\text{GHz}$ <p>donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades del campo de transmisores RF fijos, como se determina a través de una revisión electromagnética del sitio, ^a debe ser menos que el nivel de cumplimiento de cada rango de frecuencia ^b. Pueden ocurrir interferencias en la inmediaciones del equipamiento marcadas con el siguiente símbolo:</p>
RF radiada IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz	10 V/m	

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.

Información de compatibilidad electromagnética (CEM)

TABLA 3

NOTA 2: Estas directrices pueden no aplicarse a todas las situaciones. A la propagación electromagnética le afecta la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

a) Las bandas ISM (industriales, científicas y médicas) entre 0,15 MHz y 80 MHz son 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; y de 40,66 MHz a 40,70 MHz. Las bandas de radio amateur entre 0,15 MHz y 80 MHz son 1,8 MHz a 2,0 MHz, 3,5 MHz a 4,0 MHz, 5,3 MHz a 5,4 MHz, 7 MHz a 7,3 MHz, 10,1 MHz a 10,15 MHz, 14 MHz a 14,2 MHz, 18,07 MHz a 18,17 MHz, 21,0 MHz a 21,4 MHz, 24,89 MHz a 24,99 MHz, 28,0 MHz a 29,7 MHz y 50,0 MHz a 54,0 MHz.

b) Los niveles de cumplimiento en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80 MHz y en el rango de frecuencia 80 MHz a 2,7 GHz están hechas para minimizar la probabilidad de que el equipamiento de comunicaciones móvil/portátil pueda causar interferencias si es captado inadvertidamente en áreas de pacientes. Por esta razón, se ha incorporado un factor adicional de 10/3 a la fórmula utilizada para calcular la distancia de separación recomendada para transmisores en estos rangos de frecuencia.

c) Las intensidades del campo de transmisores fijos, como estaciones de radio base, teléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radio amateur, emisoras de radio AM y FM y emisoras de televisión no pueden predecirse teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, debe plantearse una revisión electromagnética del sitio. Si la intensidad del campo medida en el lugar en la que el dispositivo se usa supera el nivel de cumplimiento RF aplicable anterior, se observará el dispositivo para verificar su funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, son necesarias medidas adicionales, como reorientar y recolocar el dispositivo.

d) En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo debe ser inferior a 3 V/m.

TABLA 4

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones RF portátiles o móviles y el dispositivo

Este dispositivo está pensado para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlen las perturbaciones RF radiadas. El cliente o usuario del dispositivo puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipamientos de comunicaciones RF portátiles y móviles (transmisores) y el dispositivo como se recomienda abajo, de acuerdo a la potencia de salida máxima del equipamiento de comunicaciones

Salida nominal máxima del transmisor W	Distancia de separación de acuerdo a la frecuencia del transmisor m		
	150 kHz a 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1}\right]\sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1}\right]\sqrt{P}$	800 MHz a 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1}\right]\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,04	0,07
0,1	0,37	0,12	0,23
1	1,17	0,35	0,7
10	3,7	1,11	2,22
100	11,7	3,5	7,0

Para transmisores calificados con una potencia de salida máxima no listada anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede estimarse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto

NOTA 2: Estas directrices pueden no aplicarse a todas las situaciones. A la propagación electromagnética le afecta la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas

TABLA 5

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones RF inalámbricos

Este dispositivo está pensado para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlen las perturbaciones RF radiadas. El cliente o usuario del dispositivo puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipamientos de comunicaciones RF inalámbricos y el dispositivo como se recomienda abajo, de acuerdo a la potencia de salida máxima del equipamiento de comunicaciones

Frecuencia MHz	Potencia máxima W	Distancia	IEC 60601 Resultados de las pruebas	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - guía
385	1,8	0,3	27	27	Los equipos de comunicación RF inalámbricos no deben utilizarse más cerca de cualquier parte del dispositivo, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada, calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor Distancia de separación recomendada $E = \frac{6}{d} \sqrt{P}$ Donde P es la potencia de salida nominal máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades del campo de transmisores RF fijos, como se determine a través de una revisión electromagnética del sitio, deben ser menos que el nivel de cumplimiento de cada rango de frecuencia. Pueden ocurrir interferencias en la vecindad del equipamiento marcadas con el siguiente símbolo:
450	2	0,3	28	28	
710	0,2	0,3	9	9	
745					
780					
810	2	0,3	28	28	
870					
930					
1720	2	0,3	28	28	
1845					
1970					
2450	2	0,3	28	28	
5240	0,2	0,3	9	9	
5500					
5785					

NOTA 1: Estas directrices pueden no aplicarse a todas las situaciones. A la propagación electromagnética le afecta la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas

¡ADVERTENCIAS!

- ⚡ Este dispositivo no debe utilizarse cerca o encima de otros equipamientos electrónicos como teléfonos móviles, transmisores o productos de radio control. Si tiene que hacerlo, se debe observar el dispositivo para verificar su funcionamiento normal.
- ⚡ El uso de accesorios y cables de alimentación que no sean los especificados, con excepción de los cables vendidos por el fabricante del equipamiento o sistema como partes de repuesto para componentes internos, pueden conllevar un incremento de las emisiones y una reducción de la inmunidad del equipamiento o sistema.

 No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China. Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany. Email: shholding@hotmail.com NOVAELECTRONICA IBERIA, S.L. CIF: B84623032 · C/ Burtina, 19. Pol. Ind. Plaza. 50197 Zaragoza, España. Laboratorio STADA, S.L., Frederic Mompou 5, 08960, Sant Just Desvern (Barcelona), España.	 	Este producto cumple con los requerimientos de la Directiva 93/42/CEE de productos sanitarios, "0197" es el número de identificación del organismo notificado. La eliminación de este producto y de las pilas usadas debe realizarse de acuerdo con la normativa nacional para la eliminación de productos electrónicos. Documento No.: JDMT-8404-032 Artículo No.: 001 Versión: Z Fecha de emisión: 2020.06 Rev. 202306
---	------------------	--

